



Ospedale
Sacro Cuore-Don Calabria

Servizio autonomo di Epidemiologia e Laboratorio per le Malattie Tropicali

Primario: Dr. Zeno Bisoffi

Ed.1 del 16/12/2011

<http://www.tropicalmed.eu/Laboratorio.html>



Fondazione
Don Giovanni Calabria
per le Malattie Tropicali

Pagina 1 di 2

Controllo Qualità Ag Entamoeba histolytica/dispar Anno 2010

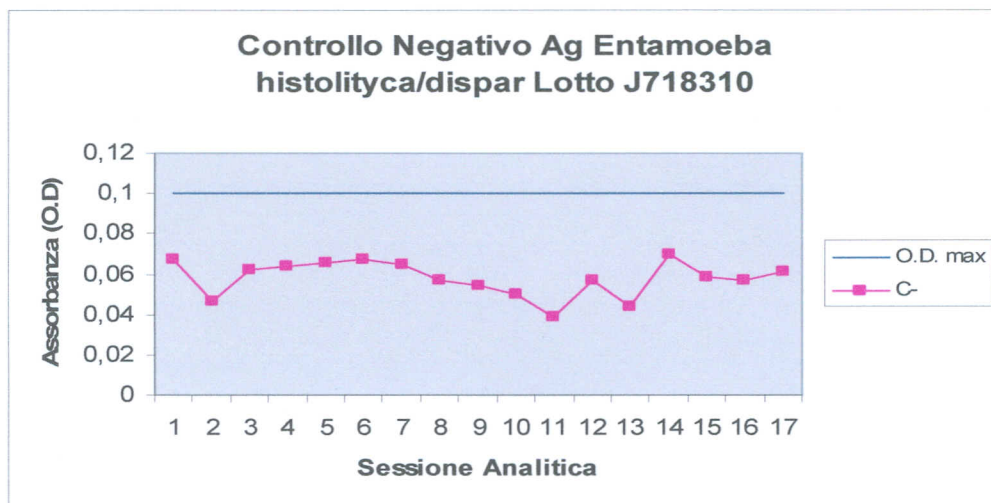


Figura 1 Controllo Negativo valore atteso ≤ 0.300

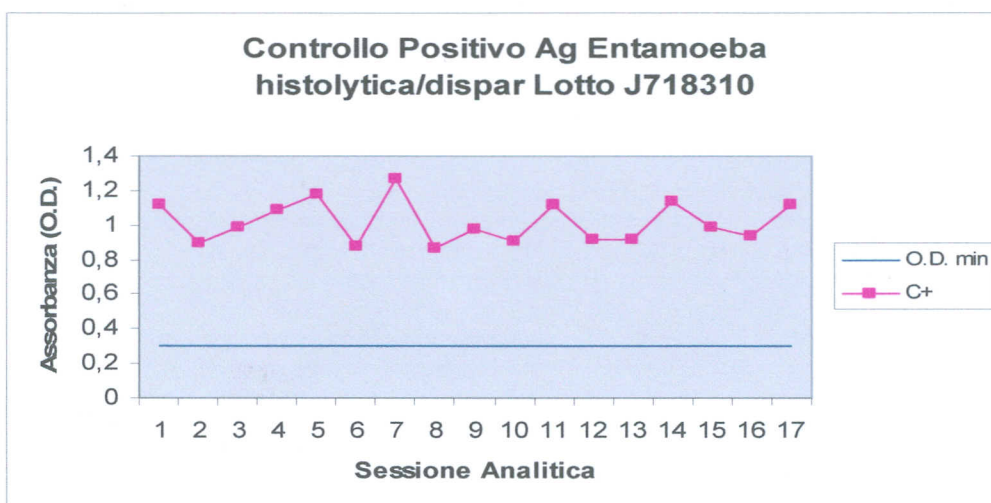


Figura 2 Controllo Positivo valore atteso ≥ 0.500

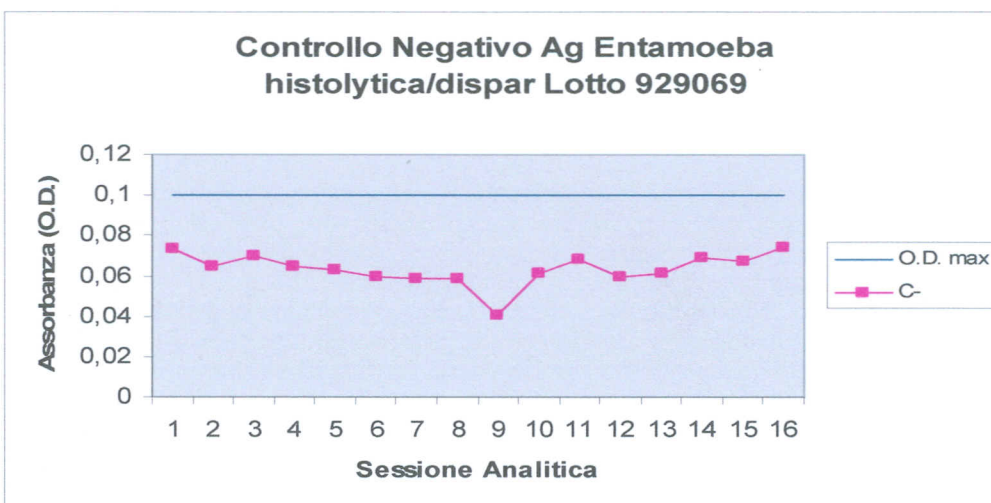


Figura 3 Controllo Negativo valore atteso ≤ 0.300

Redatto da: Tec. Stefania Bonafini

Approvato da: Dr. Zeno Bisoffi



Ospedale
Sacro Cuore-Don Calabria

Servizio autonomo di Epidemiologia e Laboratorio per le Malattie Tropicali

Primario: Dr. Zeno Bisoffi

Ed.1 del 16/12/2011

<http://www.tropicalmed.eu/Laboratorio.html>



Fondazione
Don Giovanni Calabria
per le Malattie Tropicali
Pagina 2 di 2

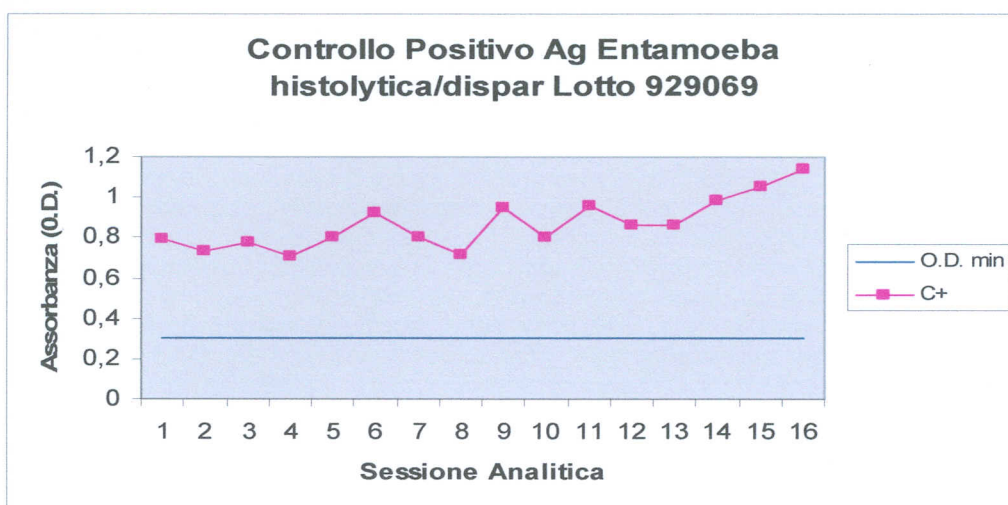


Figura 4 Controllo Positivo valore atteso ≥ 0.500

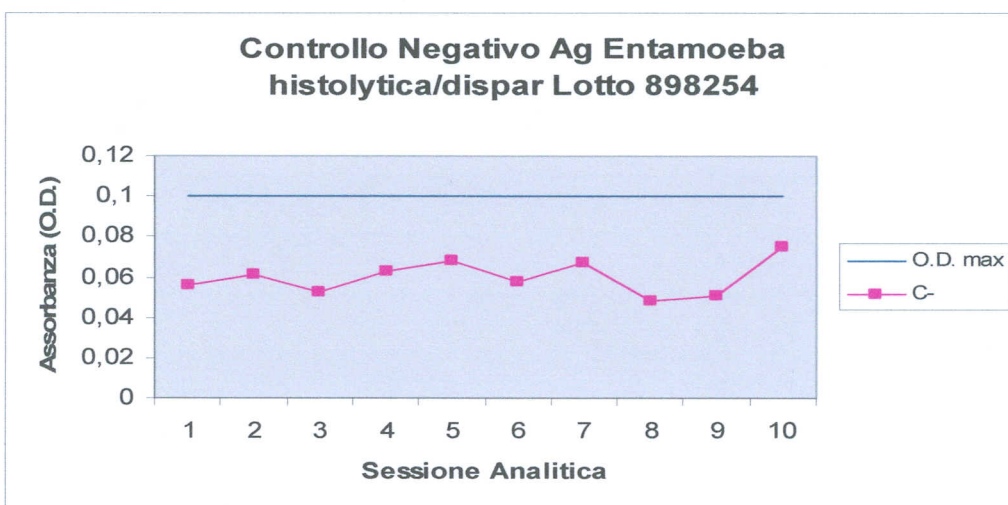


Figura 5 Controllo Negativo valore atteso ≤ 0.300

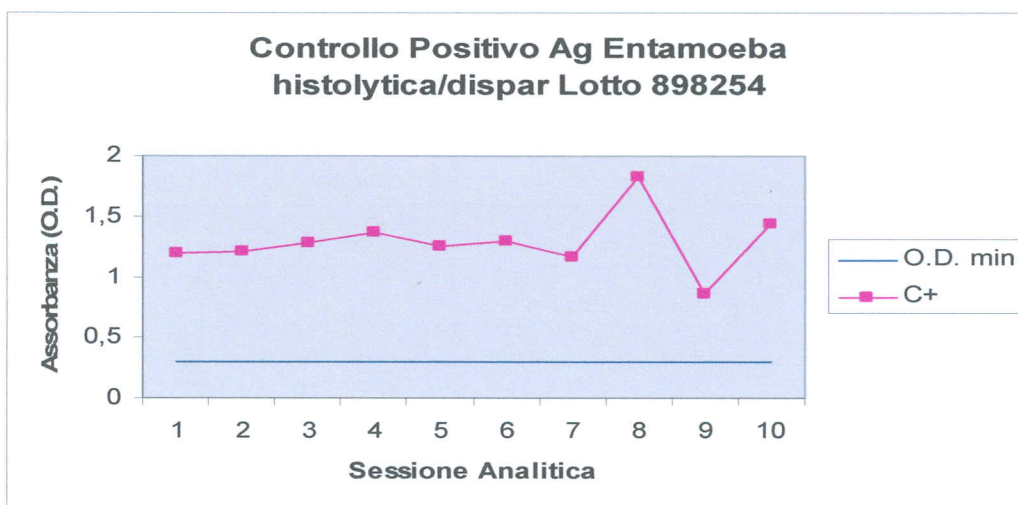


Figura 6 Controllo Positivo valore atteso ≥ 0.500

Report definitivo redatto da Stefania Bonafini il 16/12/2011 Firma

Stefania Bonafini

Firma per approvazione Dott. Zeno Bisoffi

Zeno Bisoffi

data

Redatto da: Tec. Stefania Bonafini

Approvato da: Dr. Zeno Bisoffi